


当院におけるデバルキングデバイス集計

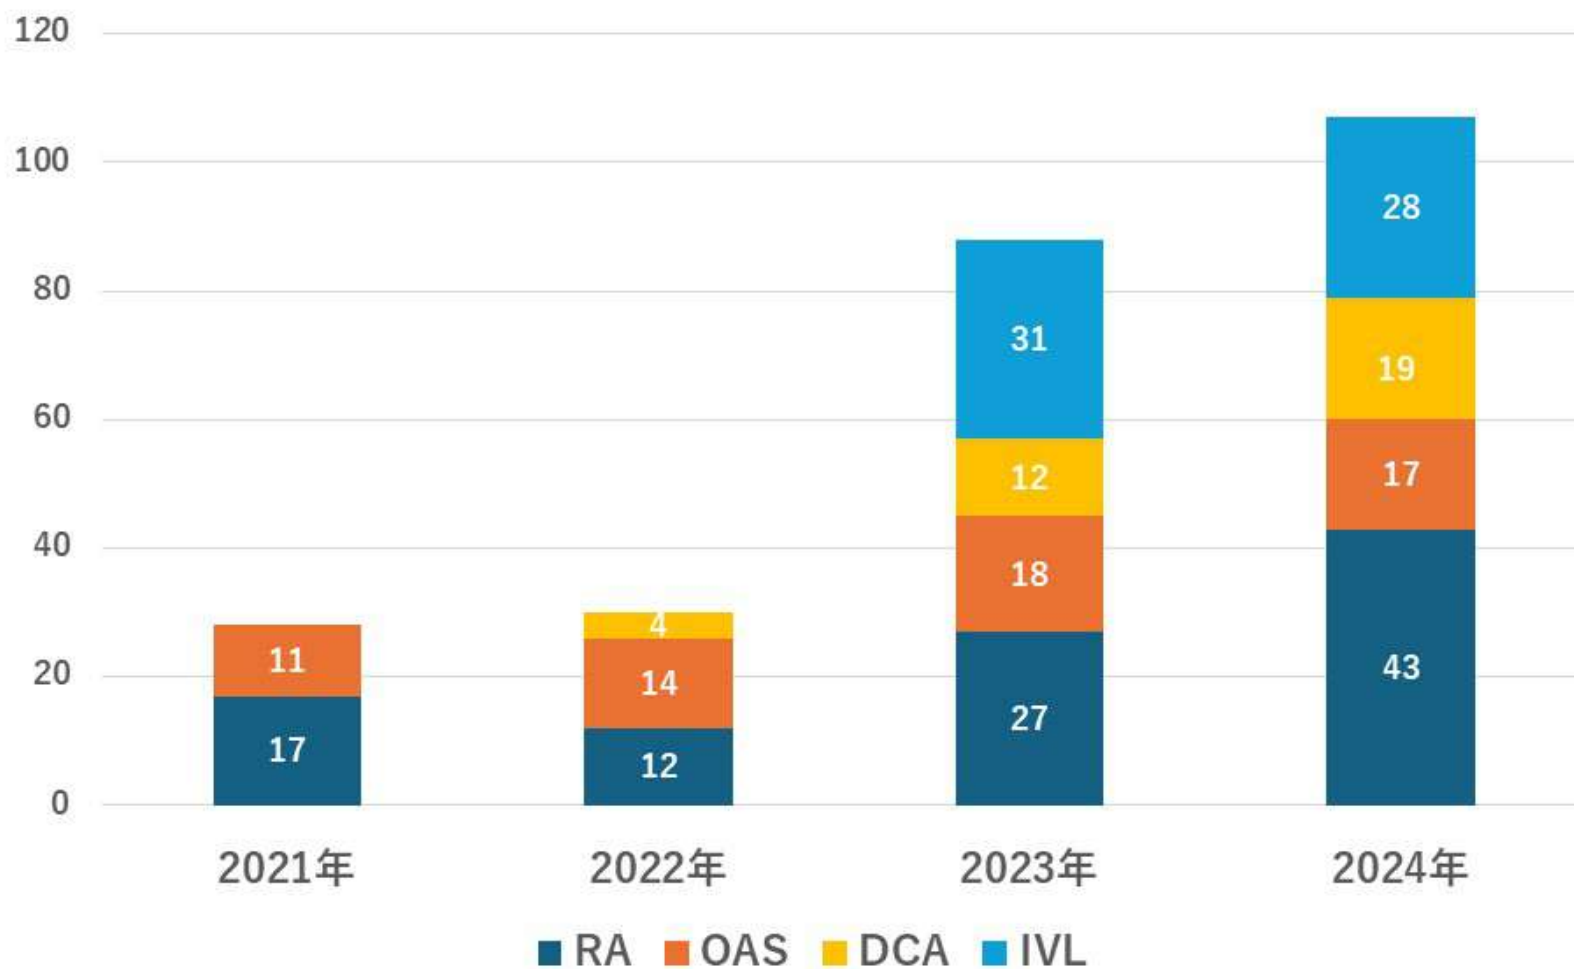

※一部, 併用症例があります.